

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43 /BVĐKBP-TCHC
V/v đề nghị chào giá gói thầu "Cung cấp vật
tư, bảo trì máy chạy thận nhân tạo"

Đồng Nai, ngày 29 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ đề m d, khoản 2, điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Bệnh viện Đa khoa Bình Phước có nhu cầu nhận báo giá mua vật tư, thực hiện bảo trì
14 máy chạy thận nhân tạo Model AK98.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.


- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Phước.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Hữu Tài; Điện thoại 0977000115.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: đơn vị gửi báo giá về địa chỉ Email [taihb.bvdkb@binhphuoc.gov.vn](mailto:taih.bvdkb@binhphuoc.gov.vn)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2025 đến trước 14 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Tên gói thầu: cung cấp vật tư, bảo trì máy chạy thận nhân tạo (theo phụ lục đính kèm).
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản vật tư: Bên cung ứng chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản vật tư, giao nhận, lắp đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Dự kiến về các điều khoản thanh toán: Hai bên thống nhất khi thực hiện hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, TCHC, TTBYT (Tài).

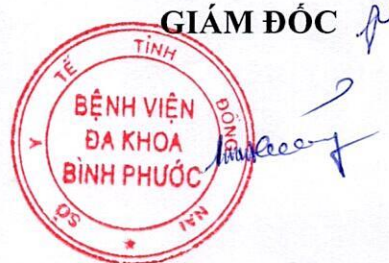

Vũ Xuân Thủy

PHỤ LỤC

Ban hành kèm theo CV số: 43 /BVĐKBP-TCHC ngày 29 tháng 7 năm 2025

Vật tư tương thích sửa chữa máy chạy thận nhân tạo Model AK98 và dịch vụ bảo trì.

I/ Vật tư thay thế:

STT	Tên vật tư	Mã Hàng	ĐVT	Số lượng
01	Lá van máy thận nhân tạo	K78700001	Cái	14
02	Bo in/out cảm biến (General I/O board)	K40489002	Cái	1
03	Bơm dịch máy thận	K40503001	Cái	1
04	Cảm biến đầu hút dịch	K40384001	Cái	2
05	Đầu cắm hút dịch (Compl.conector male kit red and blue)	K40409001	Cái	5

II/ Dịch vụ bảo trì:

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng
01	Máy chạy thận nhân tạo + Model: AK98 + Nước sản xuất: Thuy Điện. + Hãng sản xuất: Grampro. - Thời gian thực hiện: 12 tháng - Số lần thực hiện: 04 lần/năm (theo chu kỳ 03 tháng/ lần) - Kỹ sư thực hiện: Kỹ sư được đào tạo bảo trì máy chạy thận của hãng Grampro.	Cái	14

Quy trình bảo trì

STT	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	CHI TIẾT CÔNG VIỆC
01	VỆ SINH BÊN NGOÀI MÁY	Dùng vải mềm với cồn để vệ sinh bên ngoài máy
02	VỆ SINH BÊN TRONG MÁY	Tháo nắp máy máy, vệ sinh bụi, muối bám bên trong máy
03	THAY THẾ PHỤ KIỆN BẢO DƯỠNG	Thay lọc gió cho nguồn máy, vỏ máy Thay thế Fil lọc cổng A-B, Bicart Thay thế oring cổng A-B (đực) Thay thế oring cổng A-B (cái) Thay thế oring bầu deaerating Thay thế oring bypass Thay thế zoăng cổng giữ quả lọc UFD (nếu cần) Thay thế cổng hút mẫu Thay thế oring bicart Thay thế oring bầu trộn dịch
04	ĐO AN TOÀN ĐIỆN	Đo toàn bộ máy

05	HIỆU CHUẨN DÒNG	Hiệu chuẩn dòng (Variable flow)
06	HIỆU CHUẨN BỘ ĐO RÚT CÂN	Hiệu chuẩn UF (Ultrafiltration)
07	HIỆU CHUẨN ĐỘ ĐIỆN DẪN	Hiệu chuẩn độ điện dẫn: Conductivity A,B,P
08	HIỆU CHUẨN CẢM BIẾN PHÁT HIỆN DÂY MÁU	Hiệu chuẩn Primming detector
09	KHỞI ĐỘNG LẠI MÁY	Thực hiện Function check lại máy



