

Số: 792/YCBG-BVĐK.

Bình Phước, ngày 05 tháng 7 năm 2023.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư sửa chữa máy CT Scanner 128 lát cắt.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Hữu Tài;
Chức vụ: PTP – TCHC; Điện thoại 0977000115; Email phantaibvdkbp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Email phantaibvdkbp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Bo mạch điều khiển phần động Gantry máy CT Scanner 128 lát cắt

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bo mạch điều khiển phần động Gantry máy CT Scanner 128 lát cắt	<ul style="list-style-type: none">- Module: UMAR2A_SX 2.- Xuất xứ: Đức- Thông tin bảo hành: Phụ tùng được bảo hành trong vòng 06 tháng kể từ ngày thay thế mới (thể hiện trên Báo cáo dịch vụ - Service report của kỹ sư Siemens Healthineers).- Thông tin chi tiết:<ul style="list-style-type: none">• Nguồn cấp đầu vào: 24VDC• Đầu vào giao tiếp: 3 cổng giao tiếp cáp quang (Fastlink)• Đầu ra giao tiếp: 2 cổng giao tiếp cáp quang (Fastlink)• Bộ nguồn xử lý trong UMAR2A: bộ chuyển đổi AC/DC gồm: 24VDC/12V ;	1	Cái

		<p>24VDC/5VDC ; -5VDC/ 3,3 VDC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chip xử lý nạp firmware: Controller FPGA 		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản vật tư: Bên cung ứng vật tư chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản vật tư, lắp đặt vào máy CT Scanner 128 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và vận hành máy hoạt động đạt yêu cầu.


3. Thời gian giao hàng dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán và bên bán có bảo lãnh hợp đồng thông qua ngân hàng, thanh toán 70% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký nghiệm thu xuất đơn bán hàng và bên bán bảo lãnh bảo hành thông qua ngân hàng.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Khoa CDHA;
- Lưu : VT, TC-HC.(TTBYT).

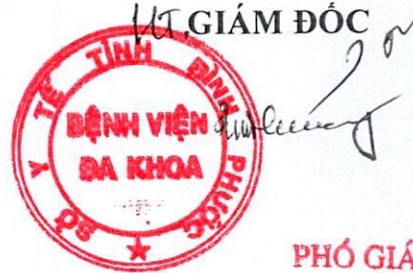

PHÓ GIÁM ĐỐC
Bs.CKII.Vũ Xuân Thủy

